Mangar
INTERNATIONAL

Mode d'emploi et garantie

Elévateur de bain gonflable

WWW.PATTERSONMEDICAL.FR

freedom

through lightweight solutions

Français

L'élévateur de bain gonflable est conçu pour procurer un bain au confort ultime. Il est actionné par le compresseur Airflo (à piles ou alimenté par le secteur).

VEUILLEZ LIRE le mode d'emploi séparé du compresseur Airflo avant d'utiliser l'élévateur de bain. S'il est correctement entretenu, l'élévateur de bain vous procurera de nombreuses années de service sans aucun problème.

AVERTISSEMENTS

- Veillez à lire et comprendre parfaitement ce mode d'emploi et celui de l'Airflo avant d'utiliser ce matériel.
- Pour garantir sa stabilité totale pendant son emploi, veillez à ce que les côtés de l'élévateur de bain touchent les parois de la baignoire lorsqu'il est entièrement gonflé.
- N'ESSAYEZ EN AUCUN CAS d'utiliser l'élévateur de bain en dehors de la baignoire.
- N'ESSAYEZ PAS de vous lever du fond de la baignoire si vous n'êtes pas assis(e) bien au centre de l'élévateur de bain (cf. Fig. 7).
- Pour la protection de l'appareil, vous devez toujours détacher chacune des ventouses avant de l'extraire de la baignoire. N'ESSAYEZ PAS de détacher les ventouses en soulevant le siège, le dossier ou la poignée.

Pièces de l'appareil standard

1 x Elévateur de bain gonflable
1 x mode d'emploi

WWW.PATTERSONMEDICAL.FR

Français

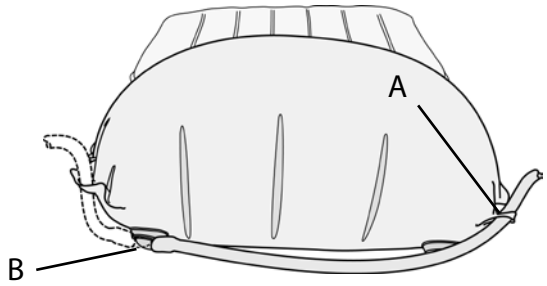

1

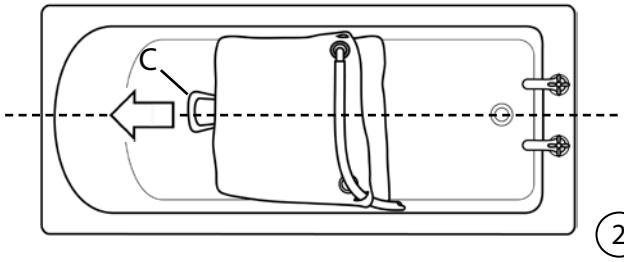

2

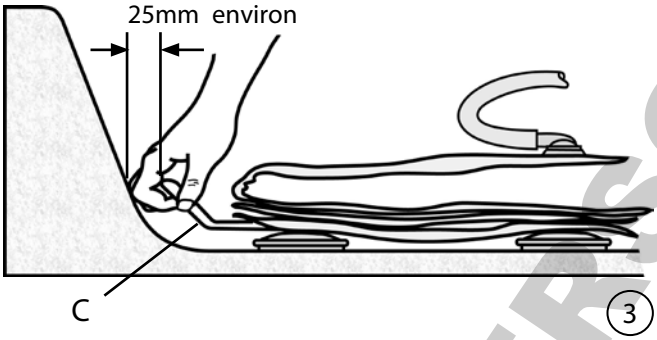

3

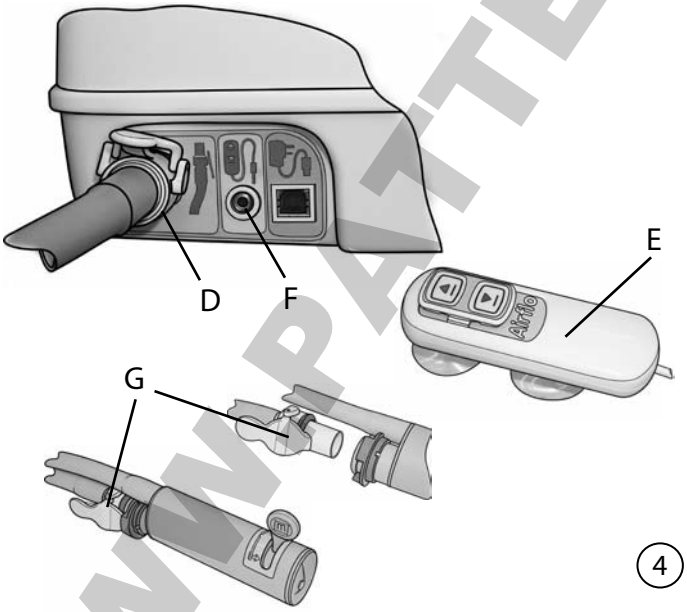

4

Installation de l'élévateur de bain gonflable dans la baignoire

- Introduisez le tuyau d'air dans la boucle au coin du dossier (A fig. 1), du côté où vous souhaitez entrer dans la baignoire et en sortir. Vous pouvez tourner le robinet d'entrée d'air (B) pour guider le tuyau dans le coin approprié.
- Pliez le dossier sur le siège de la façon indiquée dans la fig. 2. Placez l'élévateur de bain dégonflé en douceur au milieu de la baignoire vide avec la 'poignée' (C) alignée avec le centre de la baignoire.
- Tenez la 'poignée' et tirez ll'élévateur de bain vers la pente de la baignoire jusqu'à ce qu'il y ait un espace d'environ 25 mm entre la pente de la baignoire et la 'poignée' (C fig. 2 & 3).
- Appuyez sur les quatre ventouses et vérifiez qu'elles adhèrent parfaitement à la baignoire. Si nécessaire, mouillez-les pour faciliter l'adhérence.
- Rabattez le dossier de sorte qu'il repose contre la pente de la baignoire.

Branchement du tuyau d'air et du boîtier de commande

Airflo à piles:

- Branchez le tuyau d'air de l'élévateur de bain sur la prise de sortie d'air de l'Airflo (D fig. 4).
- Branchez la commande à boutons-poussoirs (E) sur la prise (F).

Airflo alimenté par le secteur:

- Branchez le tuyau d'air de l'élévateur de bain sur la commande à levier (G) et branchez le tuyau d'air de la commande à levier sur la sortie d'air de l'Airflo ou la prise murale de sortie d'air si vous utilisez un système d'air installé par Mangar International.
- Si vous préférez, il existe une rallonge pour la commande à boutons-poussoirs et une rallonge du tuyau d'air pour un branchement sur l'Airflo alimenté sur le secteur à l'extérieur de la salle de bains.

WWW.PATTERSONMEDICAL.FR

Français

Essais à sec (sans eau dans la baignoire)

- Sélectionnez 'Up' sur le boîtier de commande et lorsque la soupape de sûreté se déclenche (indiqué par un sifflement), relâchez le bouton 'Up'. Appuyez fermement sur l' élévateur de bain pour garantir l'adhérence des ventouses sur la surface de la baignoire. Vérifiez que les quatre ventouses adhèrent parfaitement à la baignoire. Si nécessaire, mouillez-les pour faciliter l'adhérence.
- Tout habillé(e) et en présence d'un assistant, effectuez quelques essais 'à blanc' en suivant les présentes consignes (ci-dessous) jusqu'à ce que vous vous sentiez en confiance avec le produit.

Utilisation de l'élévateur de bain gonflable

AVERTISSEMENT : Veuillez noter que la sécurité intégrée au compresseur Airflo ne permet pas la descente de l'élévateur de bain si la batterie n'est pas suffisamment chargée pour le remonter. Pour tirer le meilleur parti de cette sécurité, il est IMPÉRATIF DE TOUJOURS GONFLER L'ELEVATEUR DE BAIN AU MOYEN DU BOÎTIER DE COMMANDE et de L'UTILISER pour s'immerger dans la baignoire.

Pour entrer dans la baignoire

- Remplissez la baignoire avec de l'eau à la température désirée (l'élévateur de bain étant gonflé et placé dans la baignoire).
- L'élévateur de bain étant gonflé à fond, asseyez-vous sur le siège, puis placez les jambes dans la baignoire (fig. 5). Veillez à vous asseoir au centre et à l'arrière du siège.
- Sélectionnez 'Down' pour vous immerger dans la baignoire. Tenez-vous au bord ou à une poignée de baignoire pour conserver votre équilibre pendant la descente.
  Remarque: pour un plus grand confort, vous pouvez laisser un peu d'air dans l'élévateur de bain, afin d'amortir votre descente jusqu'au fond de la baignoire (fig. 6).

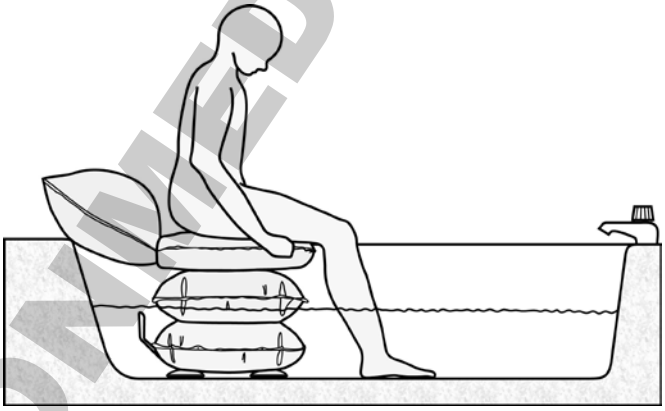

5

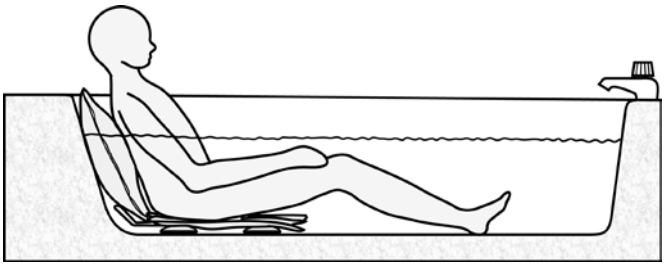

6

WWW.PATTERSONMEDICAL.FR

Français

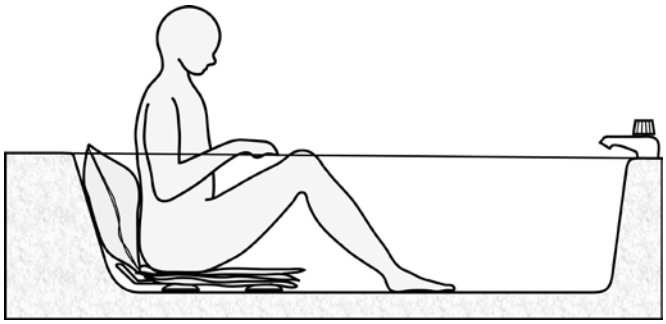

7

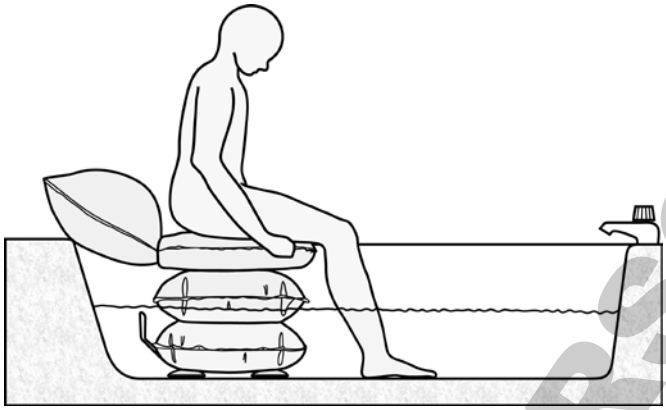

8

9

Pour sortir de la baignoire

- Après votre bain, ASSEYEZ-VOUS BIEN DROIT AU CENTRE ET À L'ARRIÈRE DU SIÈGE, EN REPLIANT LES PIEDS ET LES GENOUX (fig. 7).

  REMARQUE: En gonflant partiellement l'élévateur de bain, le dossier se gonfle et vous aide à vous asseoir bien droit(e).
- Lorsque vous désirez sortir de la baignoire, sélectionnez 'Up' sur la commande.
- Vous pouvez vous arrêter à tout moment en relâchant le bouton 'Up'.
- Sélectionnez à nouveau 'Up' pour poursuivre votre montée. Gonflez l'élévateur de bain jusqu'à ce que la soupape de sûreté se déclenche (en émettant un sifflement). Si nécessaire, tenez le bord ou une poignée de la baignoire pour conserver votre équilibre au cours de la montée (cf. Fig 7 & 8).
- Sortez les jambes de la baignoire, puis mettez-vous debout.

Pour extraire l'élévateur de bain gonflable de la baignoire

- Après l'usage, videz la baignoire et détachez les ventouses du fond de la baignoire. Pour cela, soulevez le bord de deux ventouses (fig. 9) pour les détachez de la surface de la baignoire.
- Inclinez l'élévateur de bain de sorte que les ventouses détachées ne risquent pas d'adhérer à nouveau à la surface de la baignoire (pour faciliter la tâche, vous pouvez placer une petite serviette de bain sous les ventouses).
- Détachez les deux autres ventouses en soulevant leur bord de la même façon.
- Retirez l'élévateur de bain de la baignoire et débranchez le tuyau d'air.

WWW.PATTERSONMEDICAL.FR

Français

Pour le porter et le suspendre en toute facilité, pliez l'élévateur de bain comme indiqué (fig. 10) et passez la 'poignée' (C) au travers de la fente entre le siège et le dossier.

Entretien

- Nettoyez l'élévateur de bain après chaque usage.
- Vérifiez périodiquement que les ventouses sont bien attachées et intactes.
- Vérifiez que le tuyau d'air est intact.

Nous vous recommandons de faire inspecter votre élévateur de bain une fois par an soit par votre fournisseur, soit par une autre personne compétente.

Les travaux de réparation ou d'entretien ne doivent être réalisés que par votre fournisseur ou une autre personne agréée.

Nettoyage

Nettoyage périodique

- Videz la baignoire et gonflez l'élévateur de bain à fond pour le nettoyer pendant qu'il se trouve encore dans la baignoire. Dégonflez partiellement l'élévateur de bain gonflable afin de nettoyer entre le siège et la base.
- Tous les éléments peuvent être nettoyés avec un produit d'entretien ou un désinfectant liquide de marque. REMARQUE : Avant d'utiliser des produits d'entretien de marque, faites toujours un essai dans un endroit caché. Rincez avec de l'eau propre, puis essuyez ou laissez sécher à l'air libre. N'utilisez jamais de l'air chaud .

Désinfection

- L'élévateur de bain doit être gonflé à fond et pré-nettoyé avec un détersif et de l'eau, puis désinfecté avec une solution d'hypochlorite (par exemple, une solution 'Milton') ou une lingette imprégnée d'alcool pour surfaces dures. Dégonflez partiellement l 'élévateur de bain afin de désinfecter entre le siège et la base.

Stockage

Vérifiez que l'élévateur de bain est propre et parfaitement sec avant de le ranger. Rangez-le dans un endroit sec.

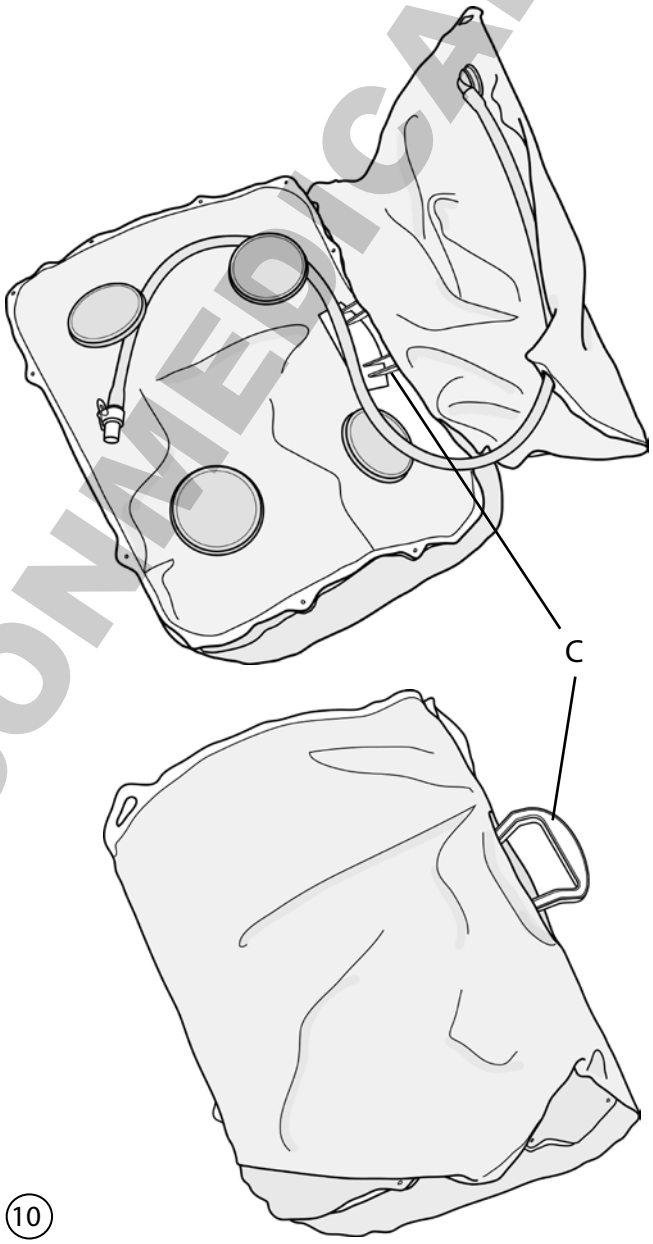

(10)

WWW.PATTERSONMEDICAL.FR

Français

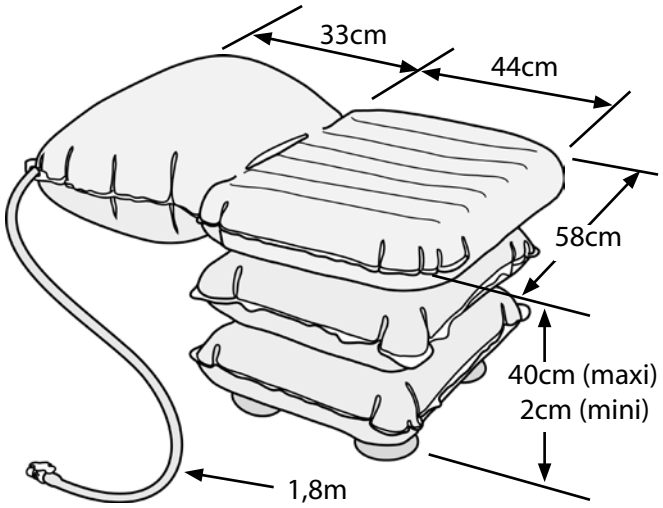

Caractéristiques techniques

Poids maxi de l'utilisateur:	150kg
Poids du Bathing Cushion:	2kg
Hauteur du siège (maxi/mini):	40cm/2cm (environ)
Largeur du siège:	58cm (environ)
Profondeur du siège:	44cm (environ)
Longueur du tuyau d'air:	1,8 mètre
Ventouses:	Ø11cm
Centres des ventouses:	30cm (largeur) 24cm (profondeur)
Pression maxi d'entrée d'air:	0,35 bar (5psi)

Garantie

Mangar International garantit ce produit pendant une période de deux ans.

Cette garantie est accordée pour tous défauts de matière ou de façon et comprend les éléments, pièces, et main d'œuvre. La garantie n'est pas valable en ce qui concerne l'usure normale, les dommages par usage abusif du matériel, la négligence, une mauvaise utilisation ou une modification ou réparation non autorisée par des personnes non qualifiées.

Les déclarations suivantes n'affectent pas les droits juridiques du consommateur. Ce produit est vendu étant entendu qu'en cas de défaut quelconque de façon ou de matière apparaissant dans les deux ans qui suivront la réception de ce produit, ce défaut sera réparé gratuitement à condition que:

(a) la preuve soit fournie (par exemple facture d'achat, bordereau de livraison) que le produit n'a pas été acheté plus de deux ans avant la date de réclamation.

(b) le défaut n'est pas attribuable à un dommage accidentel (en cours de transport ou autre), une utilisation abusive ou une réparation non autorisée.

Numéro de série élévateur de bain : .....

Date d'achat : .....

No facture / bon de livraison : .....

Mangar International se réserve le droit de modifier les spécifications du produit et / ou les informations contenues dans ce document sans avis préalable.

WWW.PATTERSONMEDICAL.FR